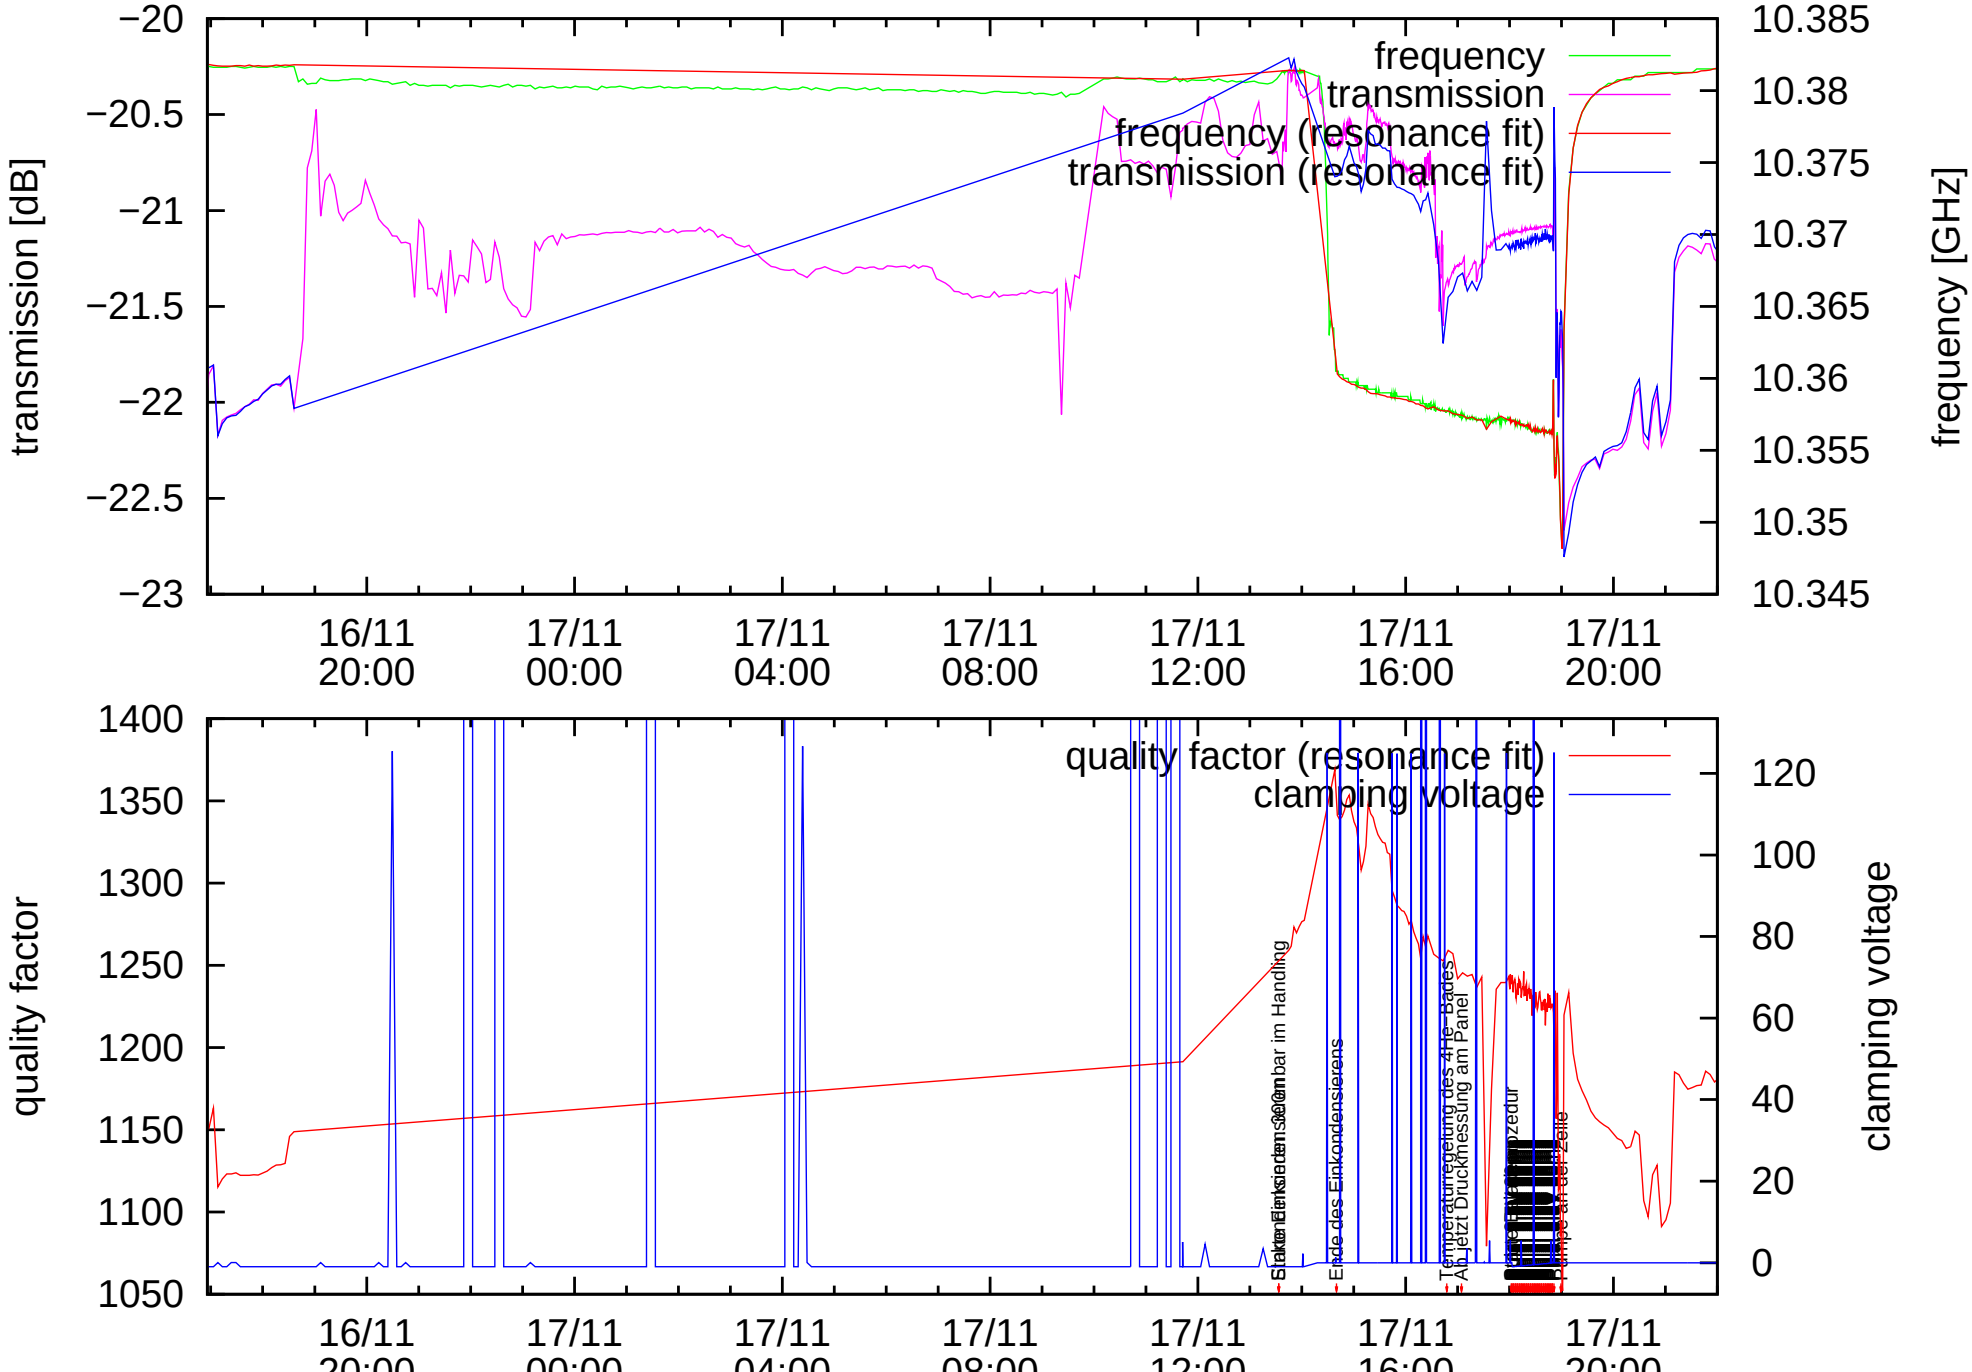
frequency
transmission
frequency (resonance fit)
transmission (resonance fit)
transmission [dB]
frequency [GHz]
−20
−20.5
−21
−21.5
−22
−22.5
−23
10.385
10.38
10.375
10.37
10.365
10.36
10.355
10.35
10.345
16/11 20:00
17/11 00:00
17/11 04:00
17/11 08:00
17/11 12:00
17/11 16:00
17/11 20:00
quality factor (resonance fit)
clamping voltage
quality factor
clamping voltage
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
120
100
80
60
40
20
0
Ende des Einkondensierens
Temperaturregelung des 4He-Bades
An, jetzt Druckmessung am Panel