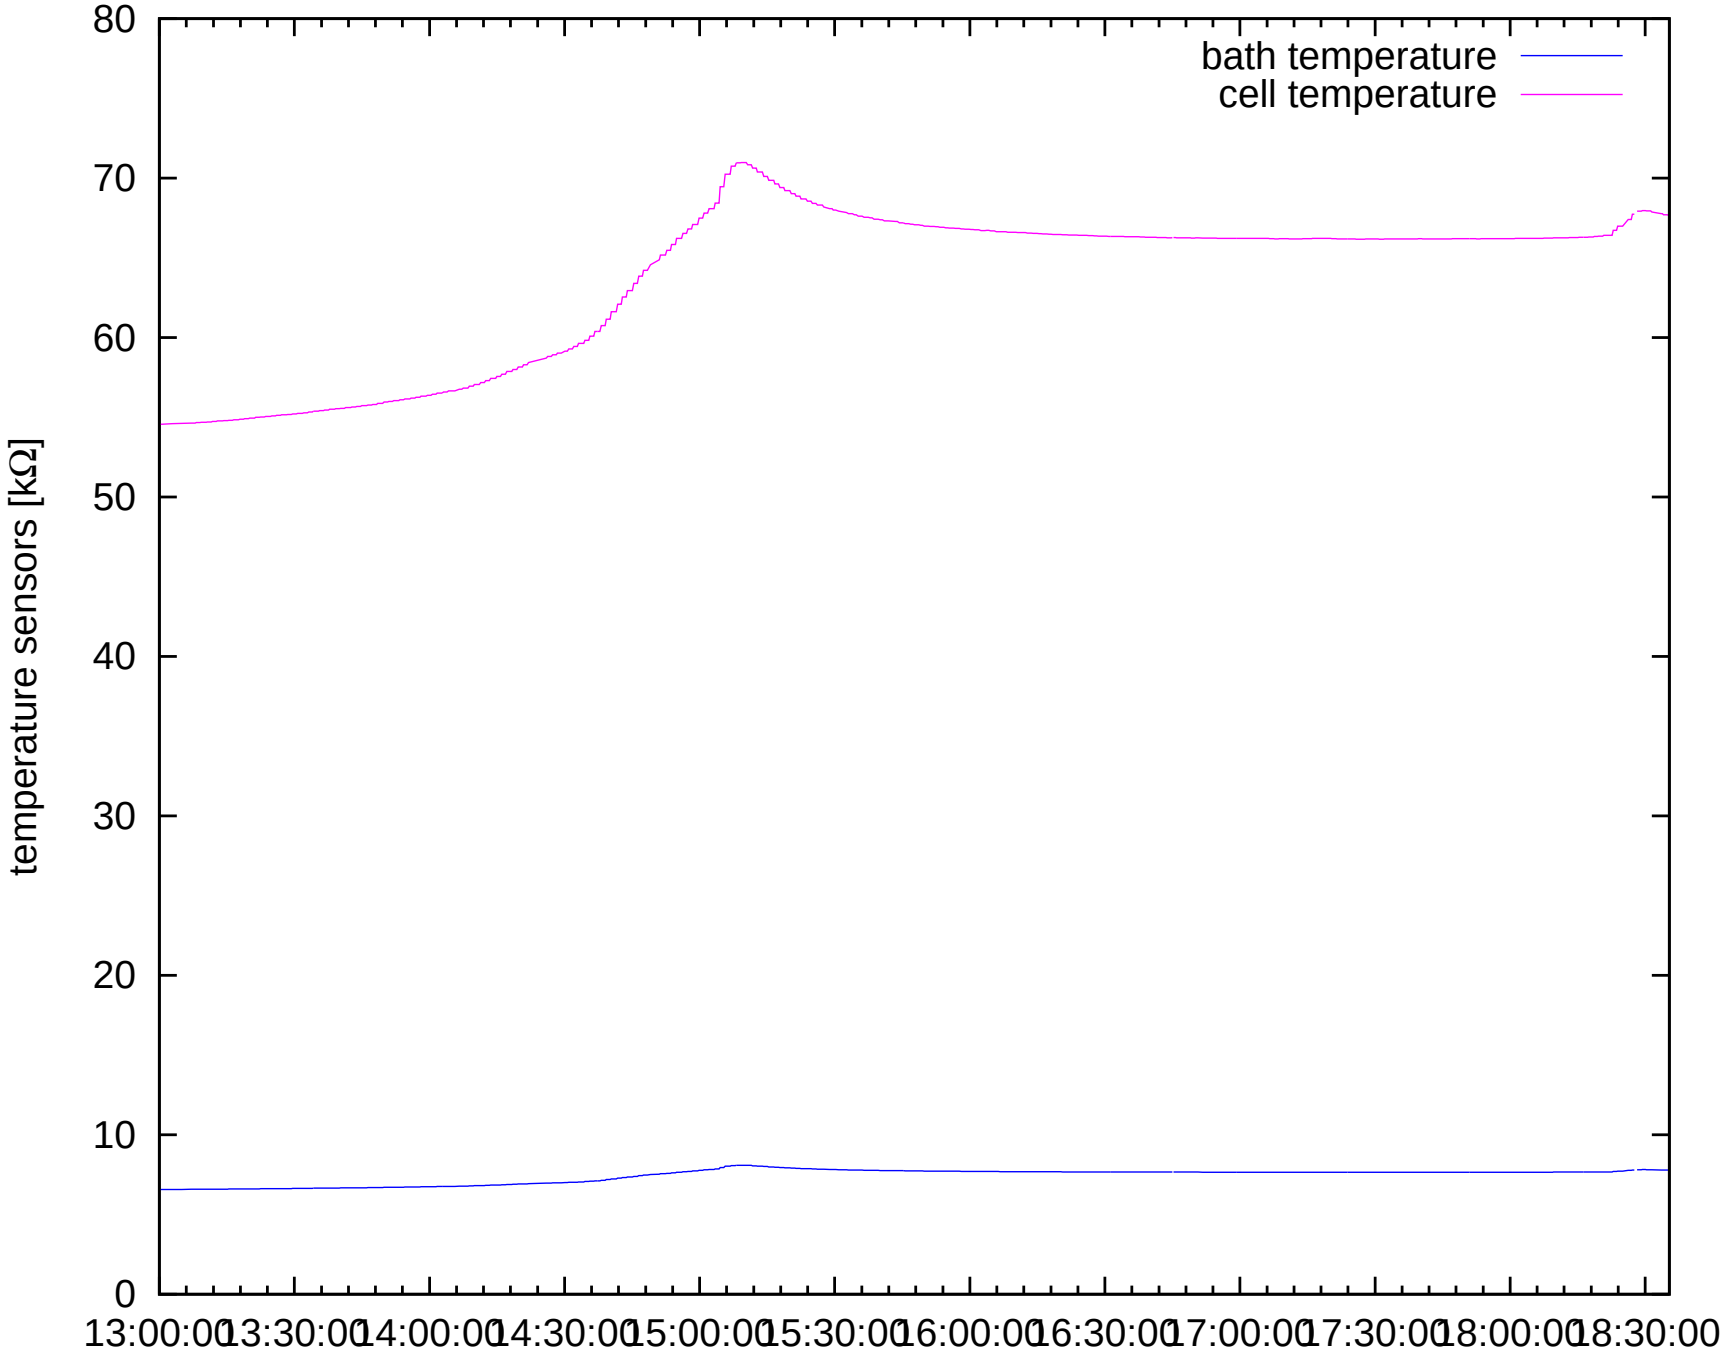
bath temperature
cell temperature
temperature sensors [kΩ]
80
70
60
50
40
30
20
10
0
13:00:00
13:30:00
14:00:00
14:30:00
15:00:00
15:30:00
16:00:00
16:30:00
17:00:00
17:30:00
18:00:00
18:30:00