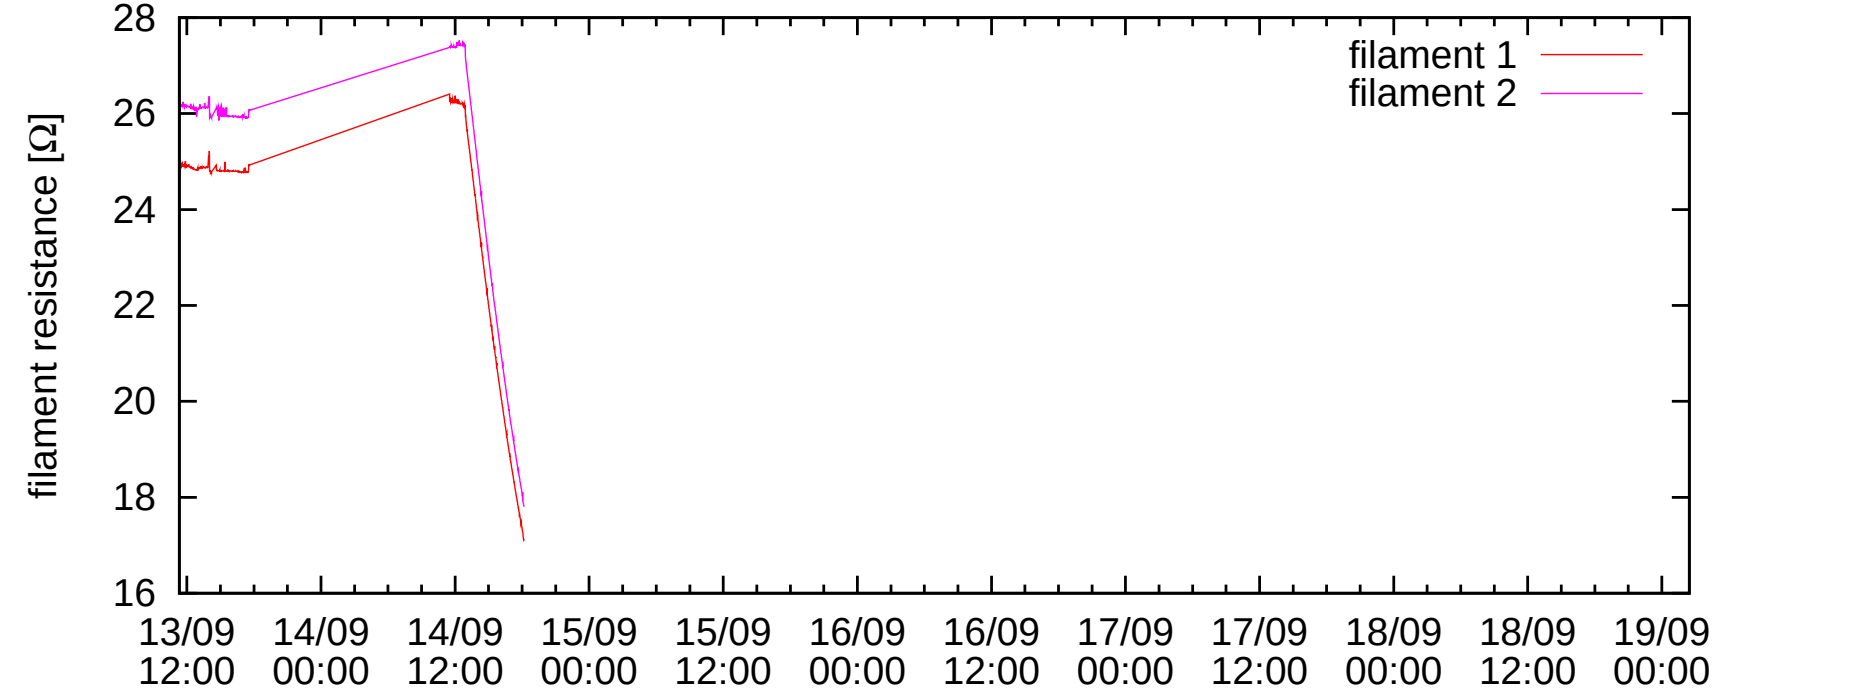
filament resistance [Ω]
filament 1
filament 2
28
26
24
22
20
18
16
13/09 12:00
14/09 00:00
14/09 12:00
15/09 00:00
15/09 12:00
16/09 00:00
16/09 12:00
17/09 00:00
17/09 12:00
18/09 00:00
18/09 12:00
19/09 00:00

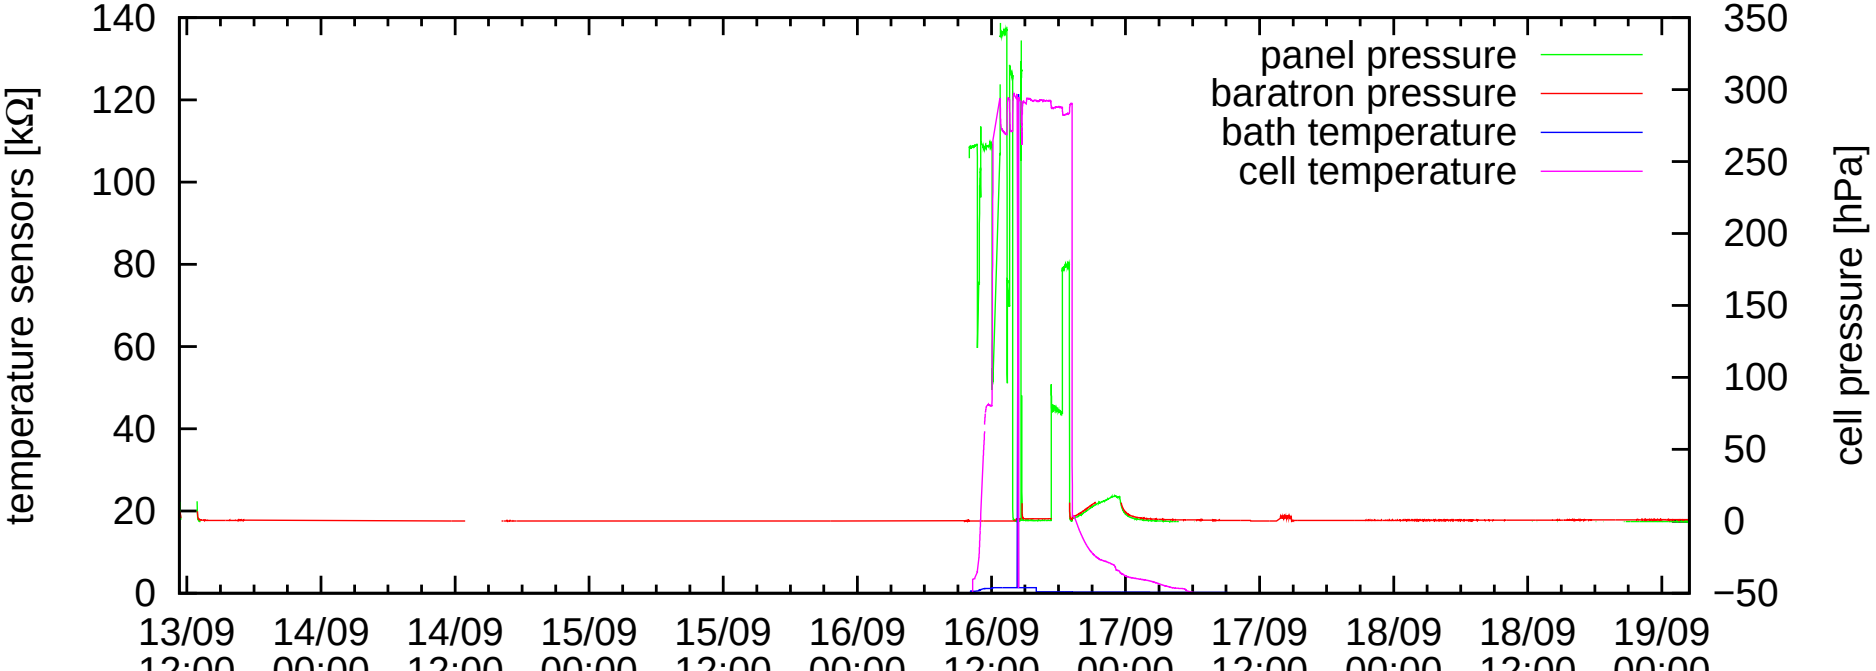
temperature sensors [kΩ]
cell pressure [hPa]
panel pressure
baratron pressure
bath temperature
cell temperature
140
120
100
80
60
40
20
0
350
300
250
200
150
100
50
0
−50
13/09 12:00
14/09 00:00
14/09 12:00
15/09 00:00
15/09 12:00
16/09 00:00
16/09 12:00
17/09 00:00
17/09 12:00
18/09 00:00
18/09 12:00
19/09 00:00