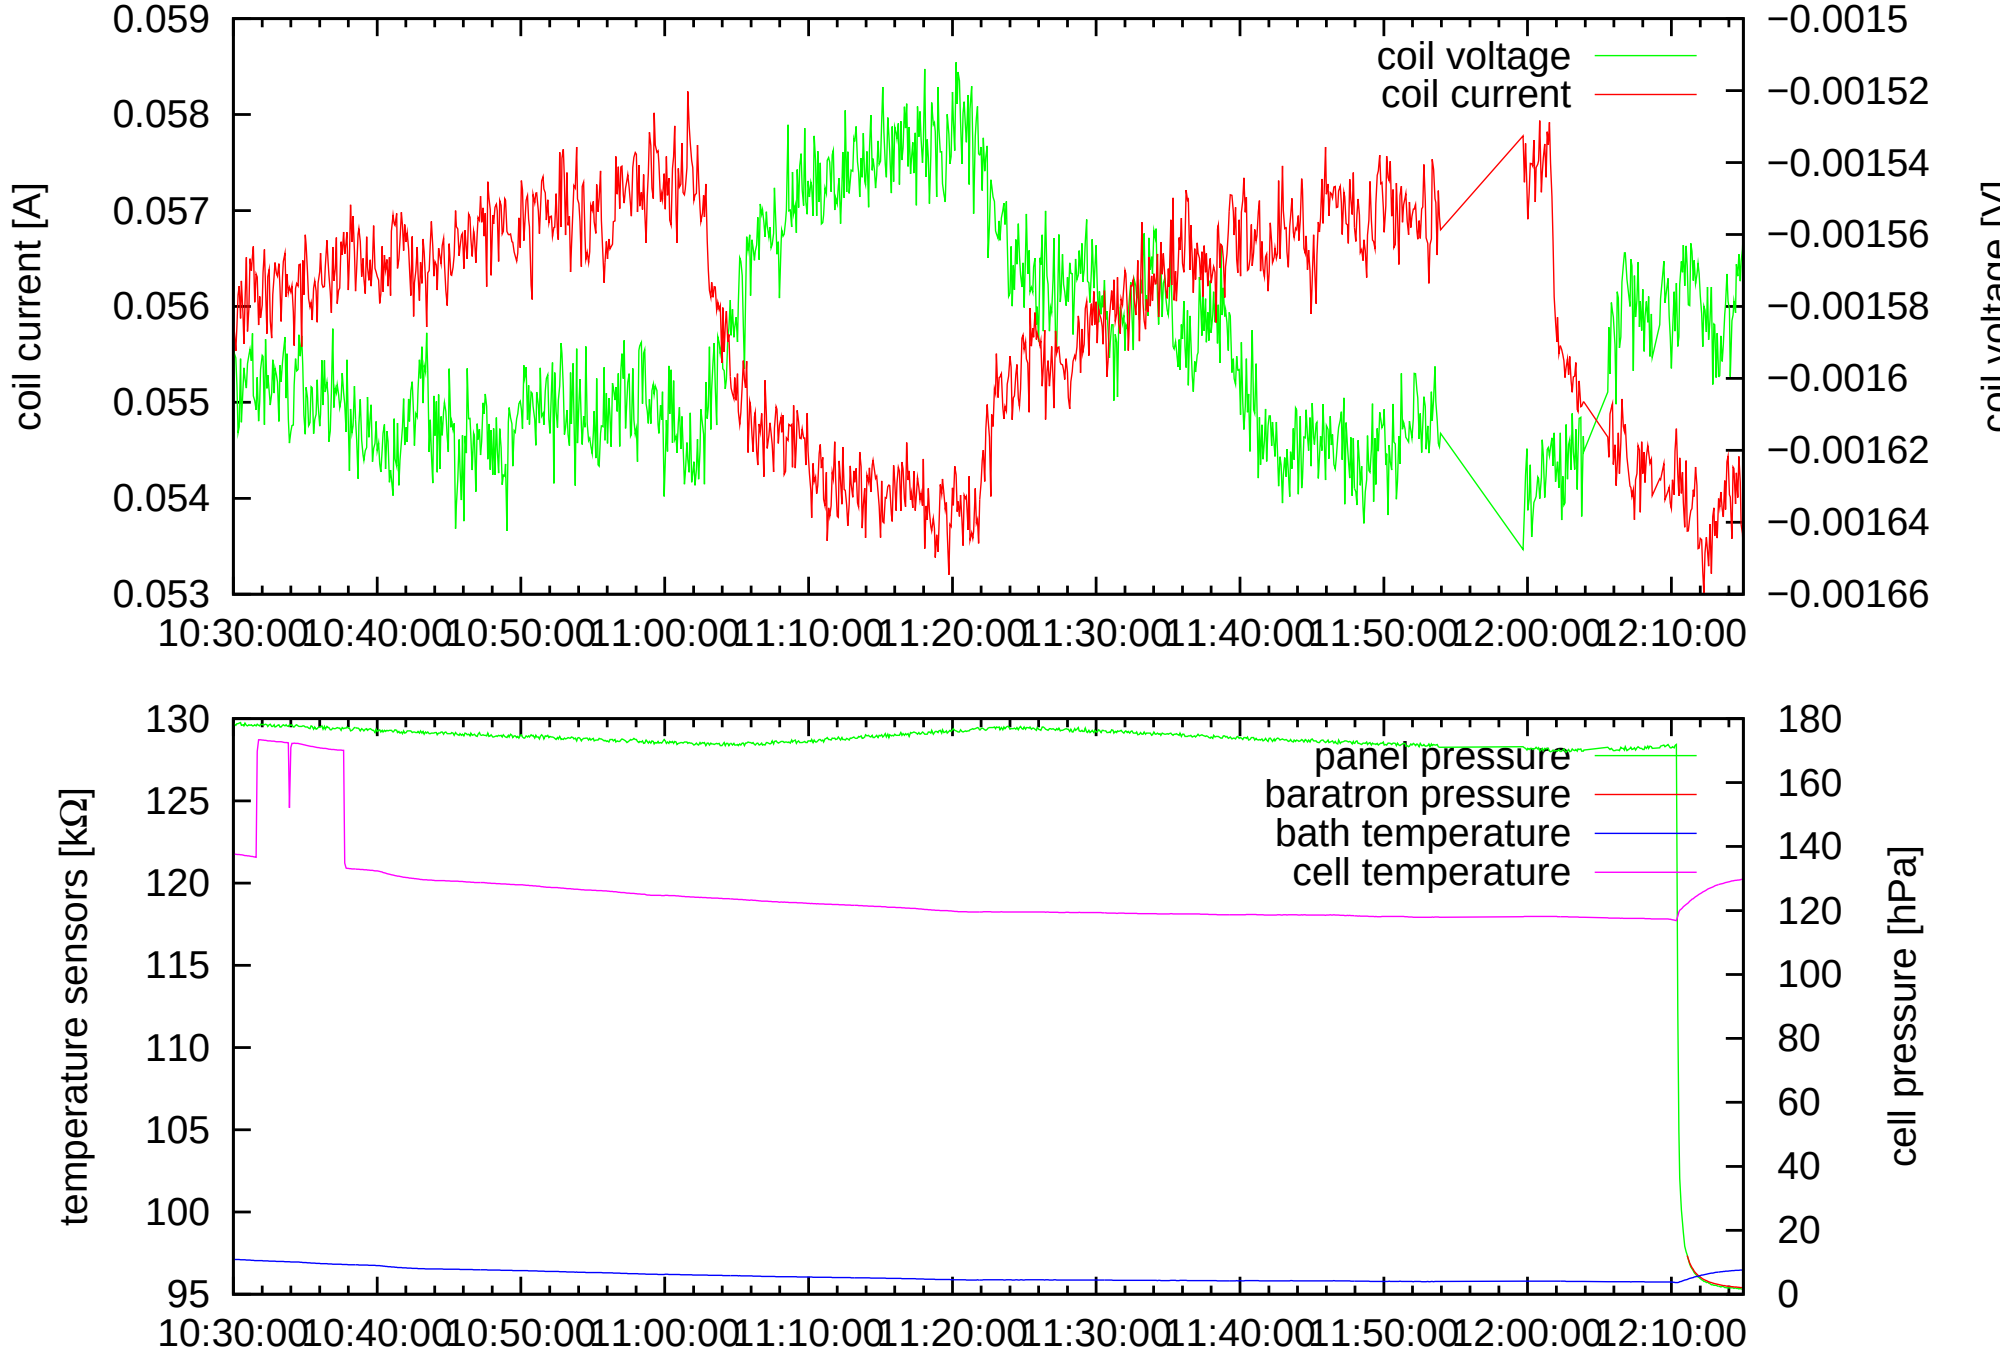
coil voltage
coil current
coil current [A]
coil voltage [V]
0.059
0.058
0.057
0.056
0.055
0.054
0.053
−0.0015
−0.00152
−0.00154
−0.00156
−0.00158
−0.0016
−0.00162
−0.00164
−0.00166
10:30:00
10:40:00
10:50:00
11:00:00
11:10:00
11:20:00
11:30:00
11:40:00
11:50:00
12:00:00
12:10:00
panel pressure
baratron pressure
bath temperature
cell temperature
temperature sensors [kΩ]
cell pressure [hPa]
130
125
120
115
110
105
100
95
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0