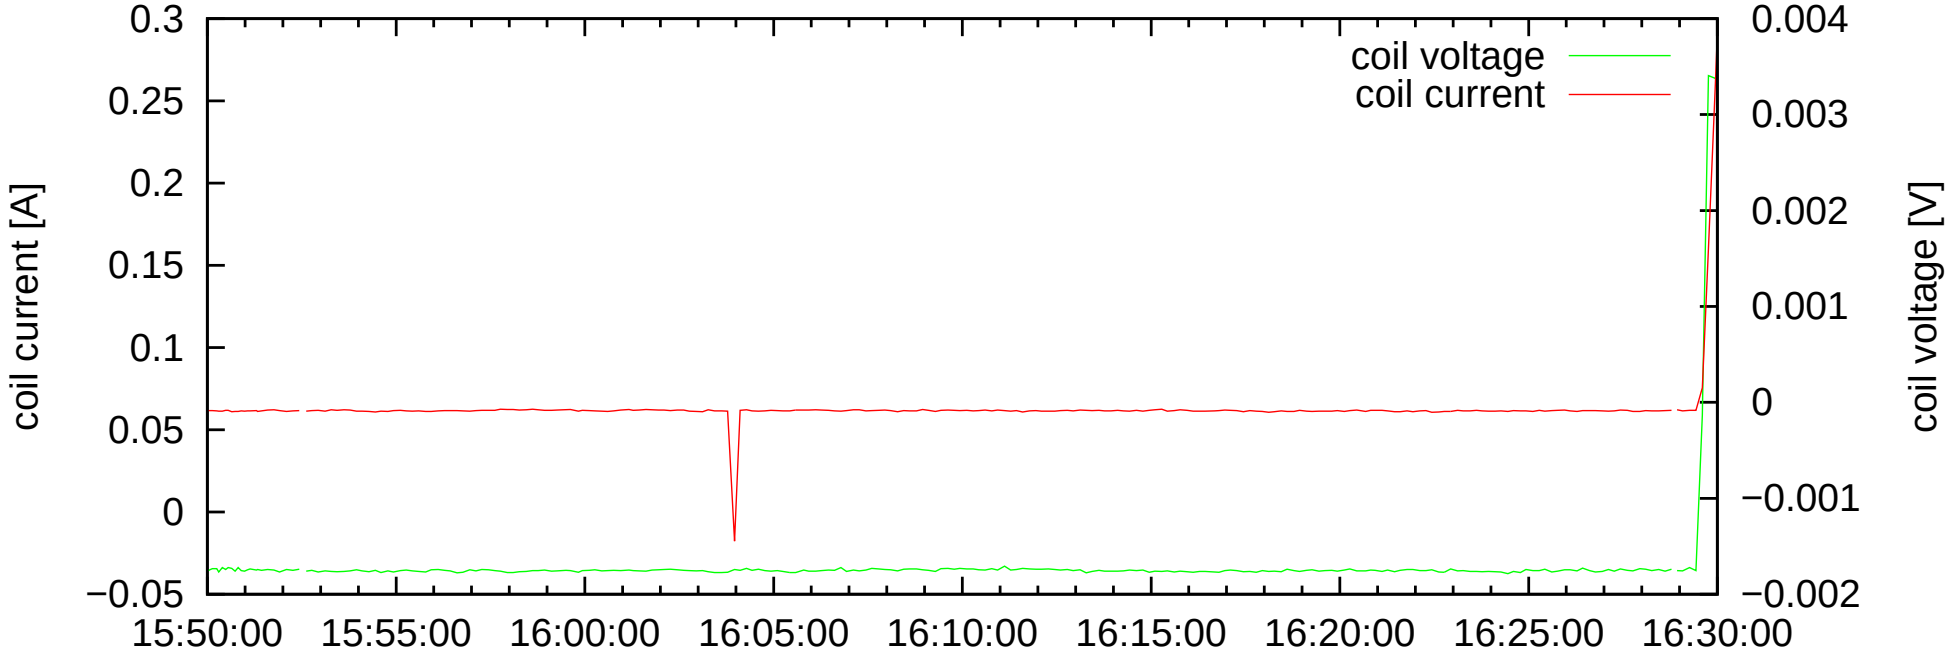
coil voltage
coil current
coil current [A]
coil voltage [V]
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
−0.05
0.004
0.003
0.002
0.001
0
−0.001
−0.002
15:50:00
15:55:00
16:00:00
16:05:00
16:10:00
16:15:00
16:20:00
16:25:00
16:30:00

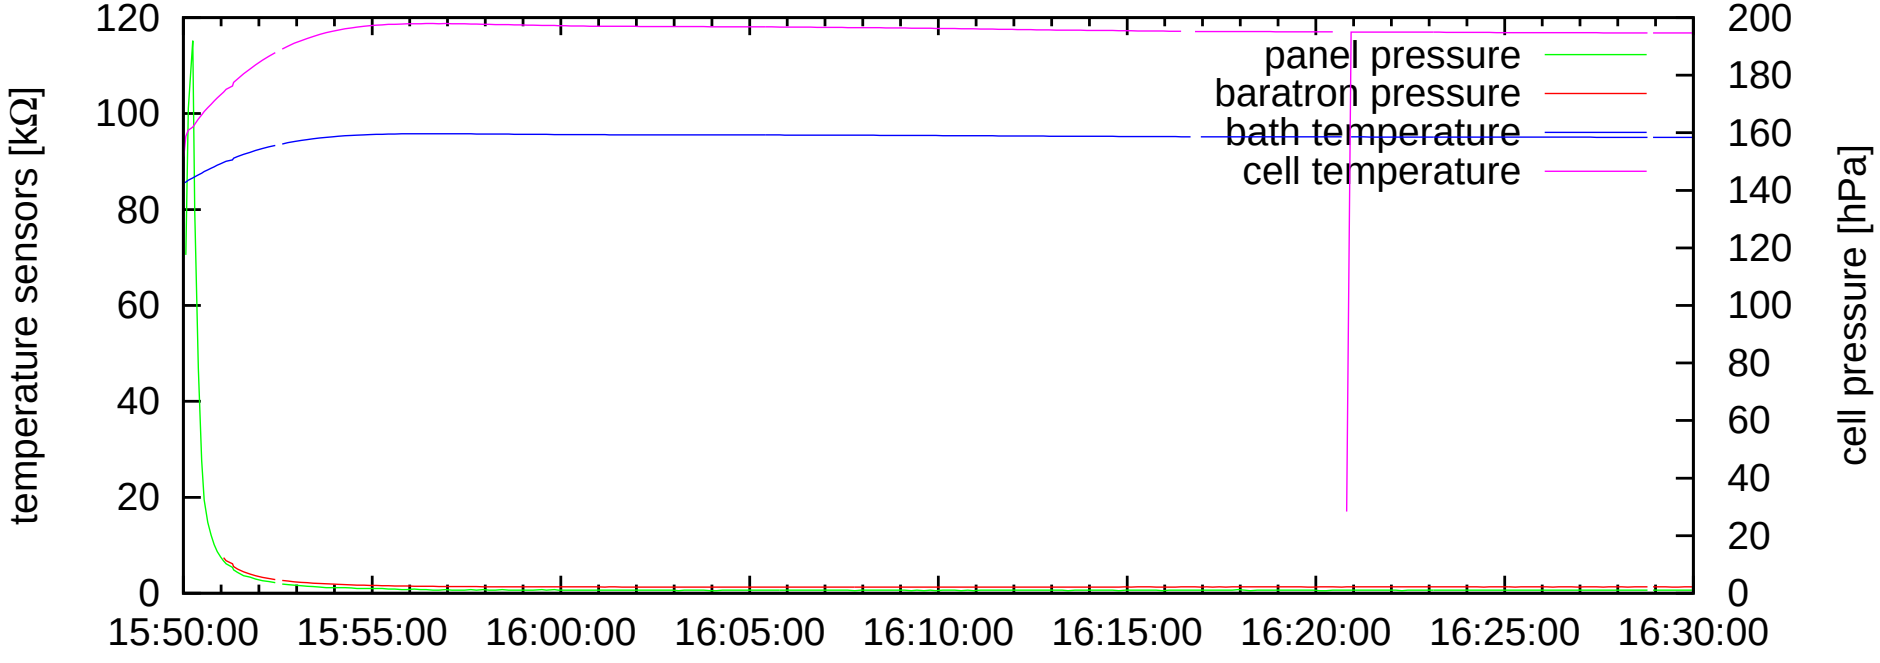
panel pressure
baratron pressure
bath temperature
cell temperature
temperature sensors [kΩ]
cell pressure [hPa]
120
100
80
60
40
20
0
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
15:50:00
15:55:00
16:00:00
16:05:00
16:10:00
16:15:00
16:20:00
16:25:00
16:30:00