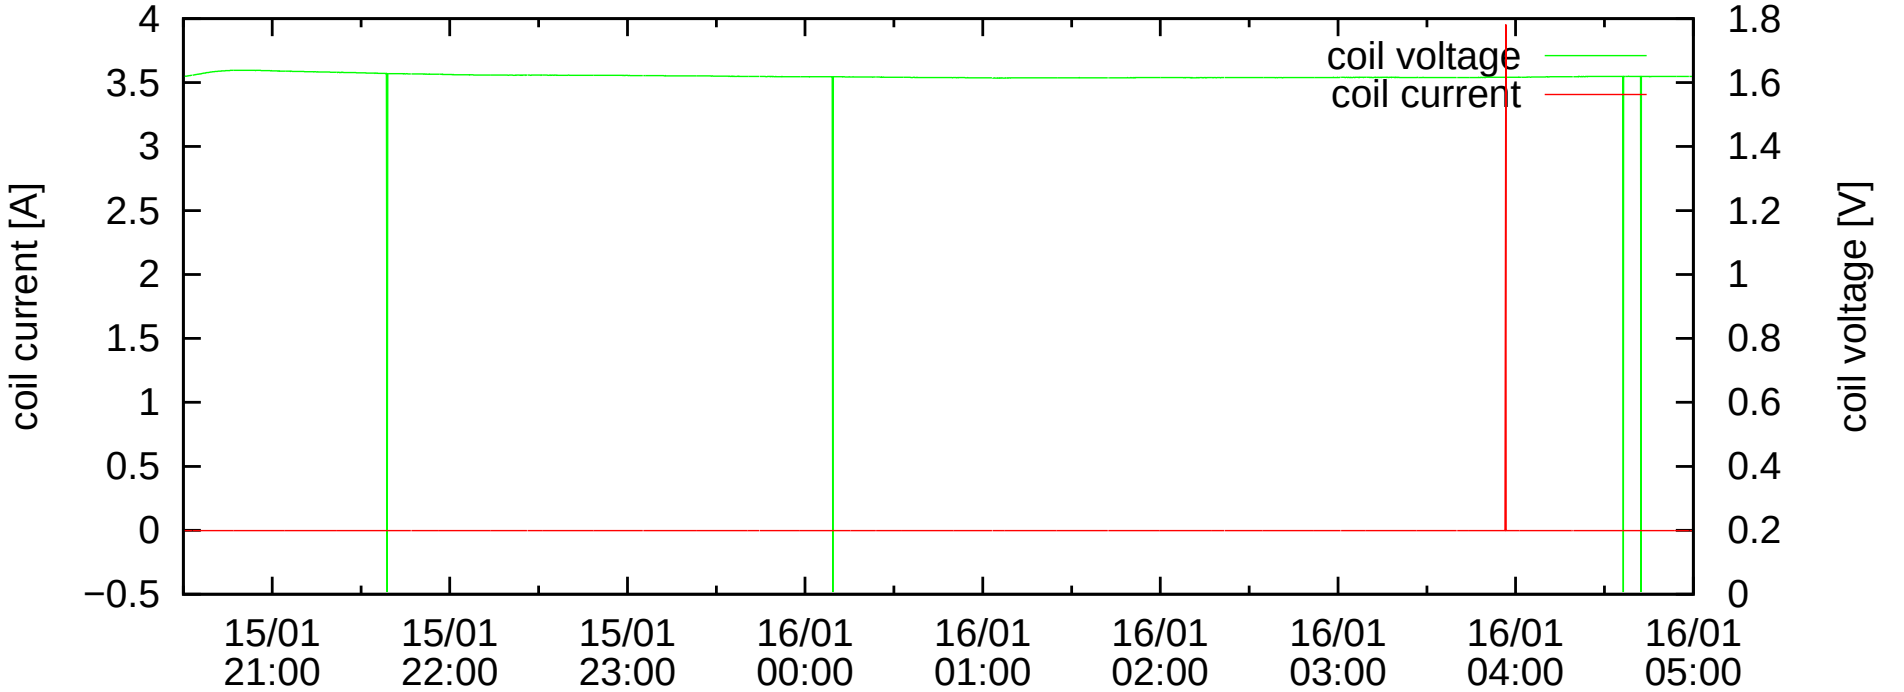
coil voltage
coil current
coil current [A]
coil voltage [V]
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
15/01 21:00
15/01 22:00
15/01 23:00
16/01 00:00
16/01 01:00
16/01 02:00
16/01 03:00
16/01 04:00
16/01 05:00

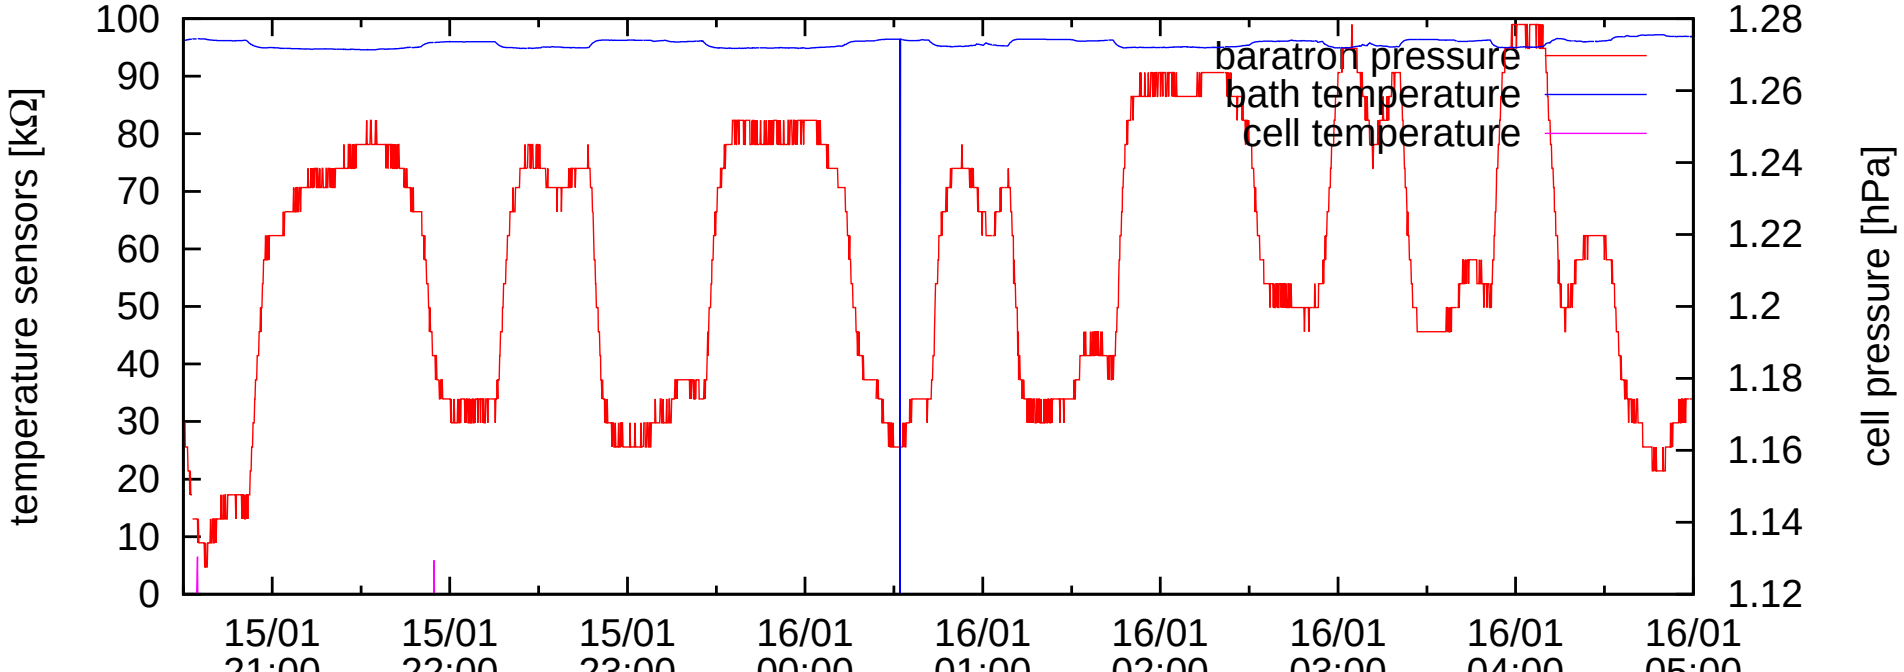
baratron pressure
bath temperature
cell temperature
temperature sensors [kΩ]
cell pressure [hPa]
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1.28
1.26
1.24
1.22
1.2
1.18
1.16
1.14
1.12
15/01 21:00
15/01 22:00
15/01 23:00
16/01 00:00
16/01 01:00
16/01 02:00
16/01 03:00
16/01 04:00
16/01 05:00