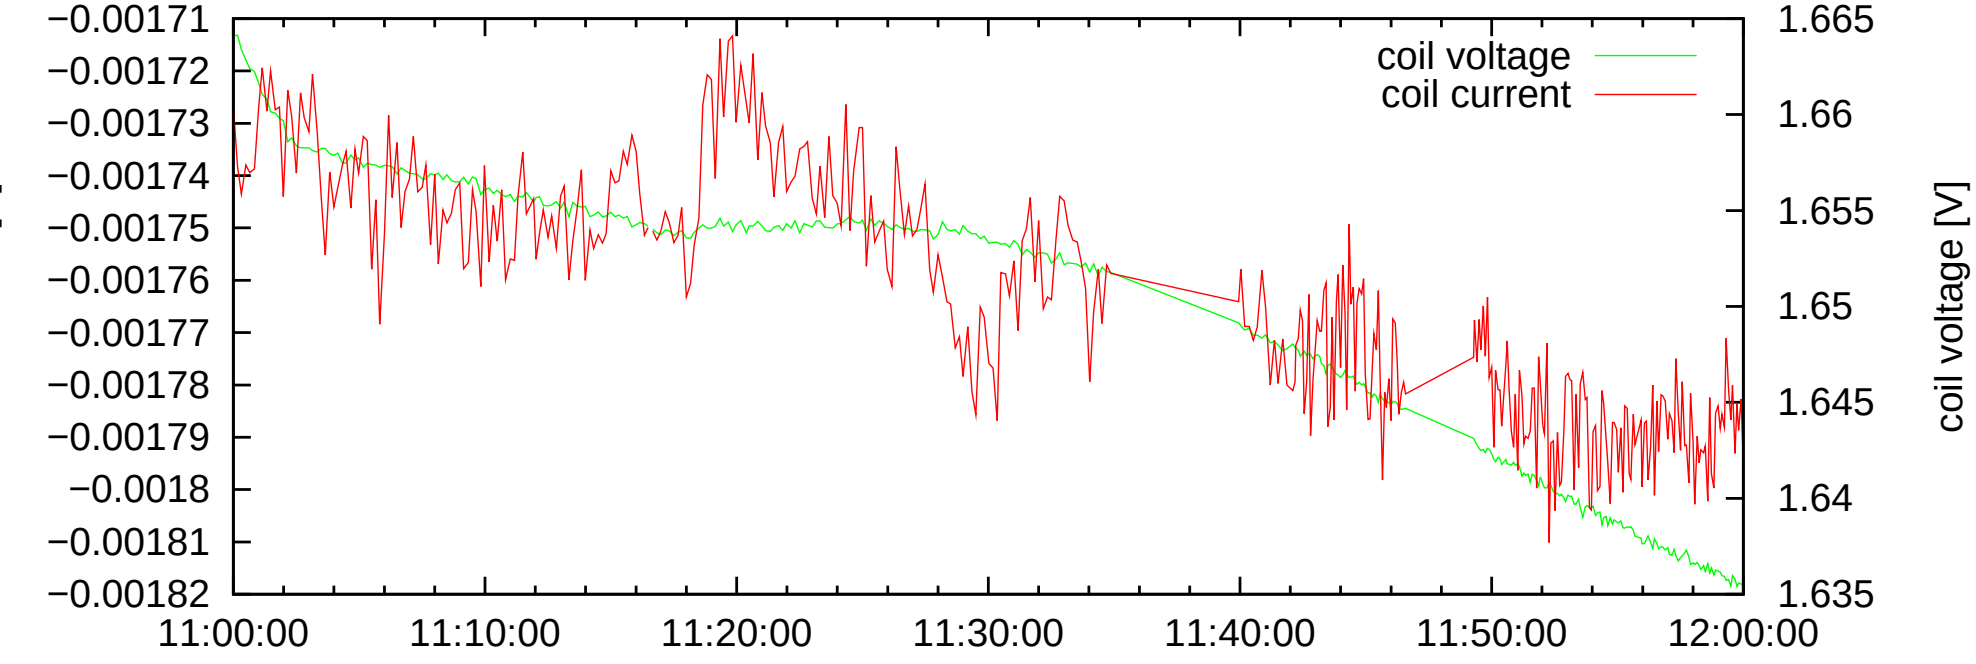
coil voltage
coil current
coil voltage [V]
−0.00171
−0.00172
−0.00173
−0.00174
−0.00175
−0.00176
−0.00177
−0.00178
−0.00179
−0.0018
−0.00181
−0.00182
1.665
1.66
1.655
1.65
1.645
1.64
1.635
11:00:00
11:10:00
11:20:00
11:30:00
11:40:00
11:50:00
12:00:00

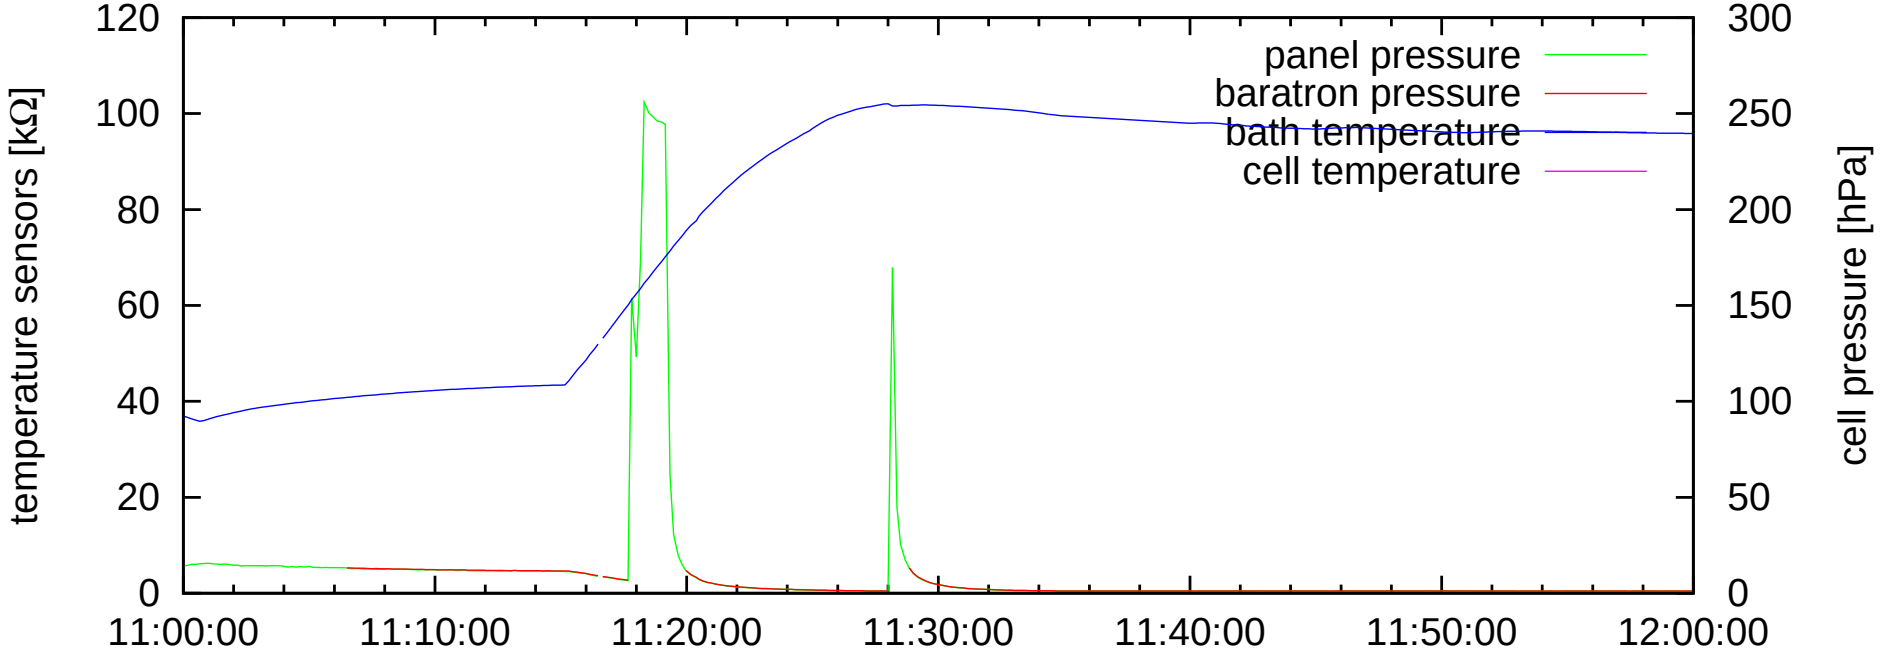
panel pressure
baratron pressure
bath temperature
cell temperature
temperature sensors [kΩ]
cell pressure [hPa]
120
100
80
60
40
20
0
300
250
200
150
100
50
0
11:00:00
11:10:00
11:20:00
11:30:00
11:40:00
11:50:00
12:00:00