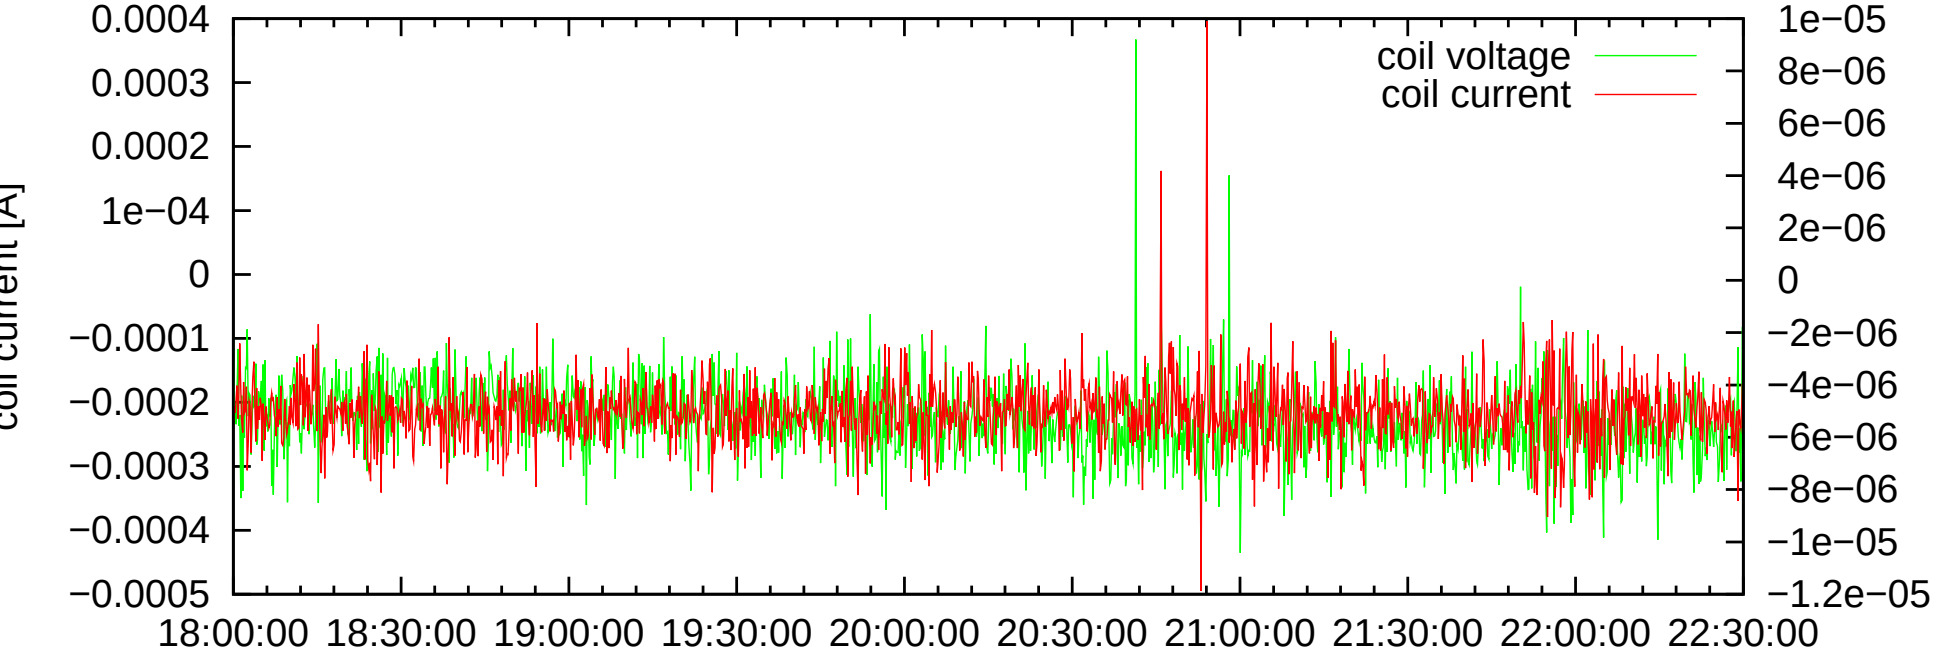
coil voltage
coil current
coil current [A]
coil voltage [V]
0.0004
0.0003
0.0002
1e−04
0
−0.0001
−0.0002
−0.0003
−0.0004
−0.0005
1e−05
8e−06
6e−06
4e−06
2e−06
0
−2e−06
−4e−06
−6e−06
−8e−06
−1e−05
−1.2e−05
18:00:00
18:30:00
19:00:00
19:30:00
20:00:00
20:30:00
21:00:00
21:30:00
22:00:00
22:30:00

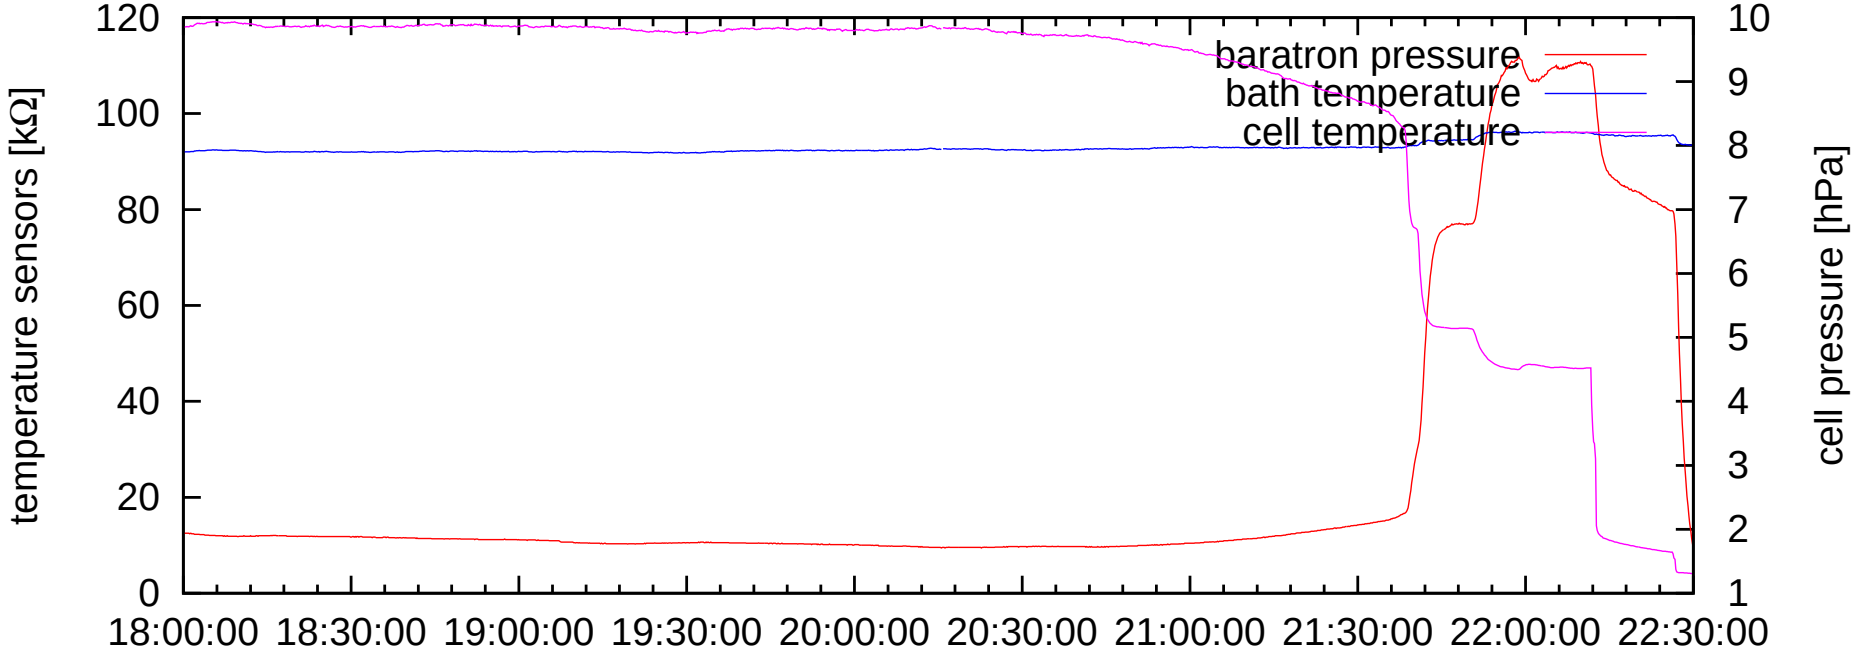
baratron pressure
bath temperature
cell temperature
temperature sensors [kΩ]
cell pressure [hPa]
120
100
80
60
40
20
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18:00:00
18:30:00
19:00:00
19:30:00
20:00:00
20:30:00
21:00:00
21:30:00
22:00:00
22:30:00