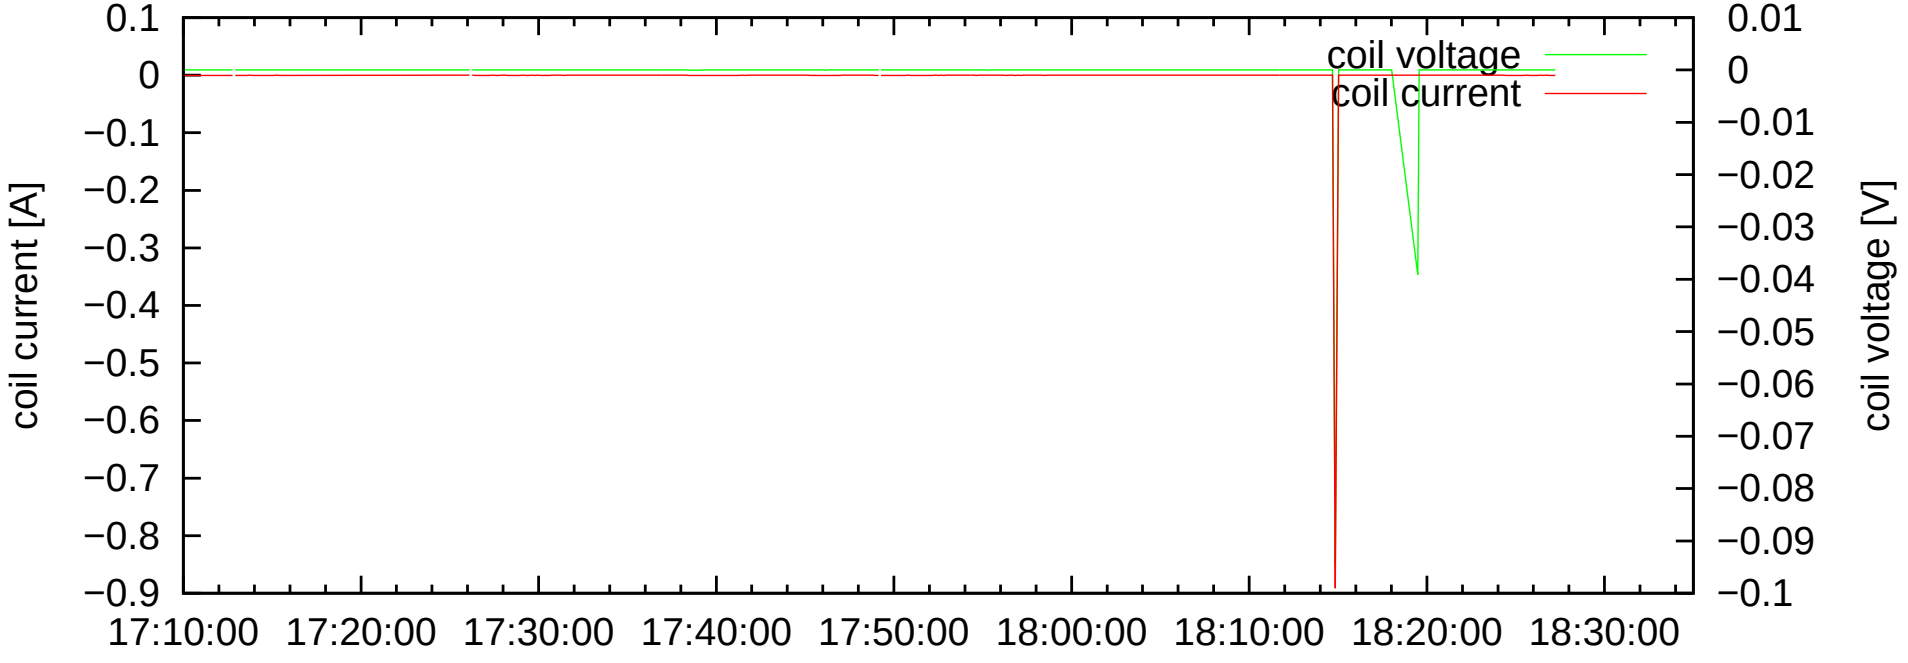
coil voltage
coil current
coil current [A]
coil voltage [V]
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−0.6
−0.7
−0.8
−0.9
0.01
0
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
−0.05
−0.06
−0.07
−0.08
−0.09
−0.1
17:10:00
17:20:00
17:30:00
17:40:00
17:50:00
18:00:00
18:10:00
18:20:00
18:30:00

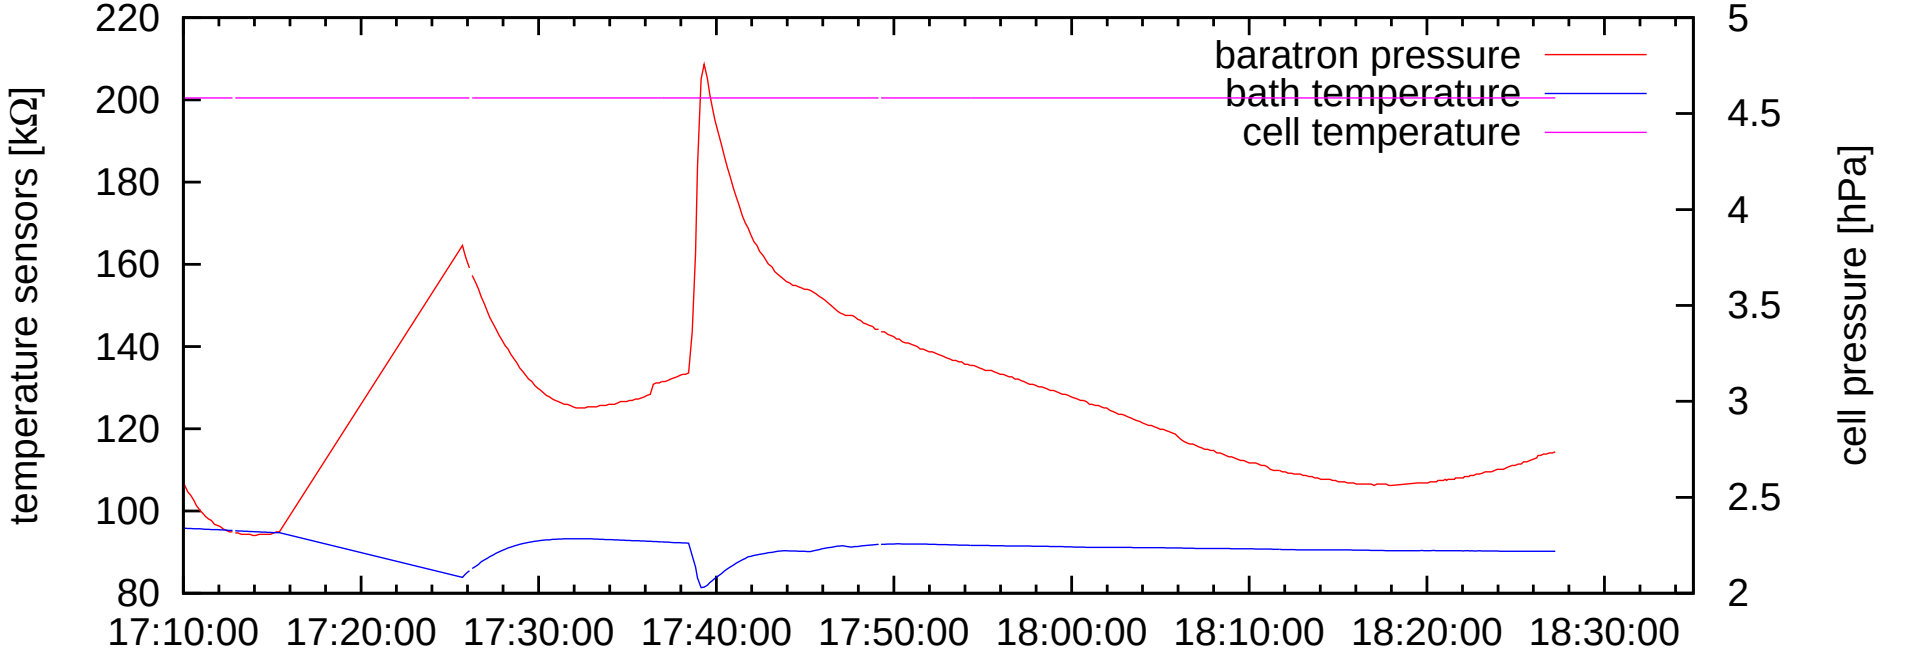
baratron pressure
bath temperature
cell temperature
temperature sensors [kΩ]
cell pressure [hPa]
220
200
180
160
140
120
100
80
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
17:10:00
17:20:00
17:30:00
17:40:00
17:50:00
18:00:00
18:10:00
18:20:00
18:30:00