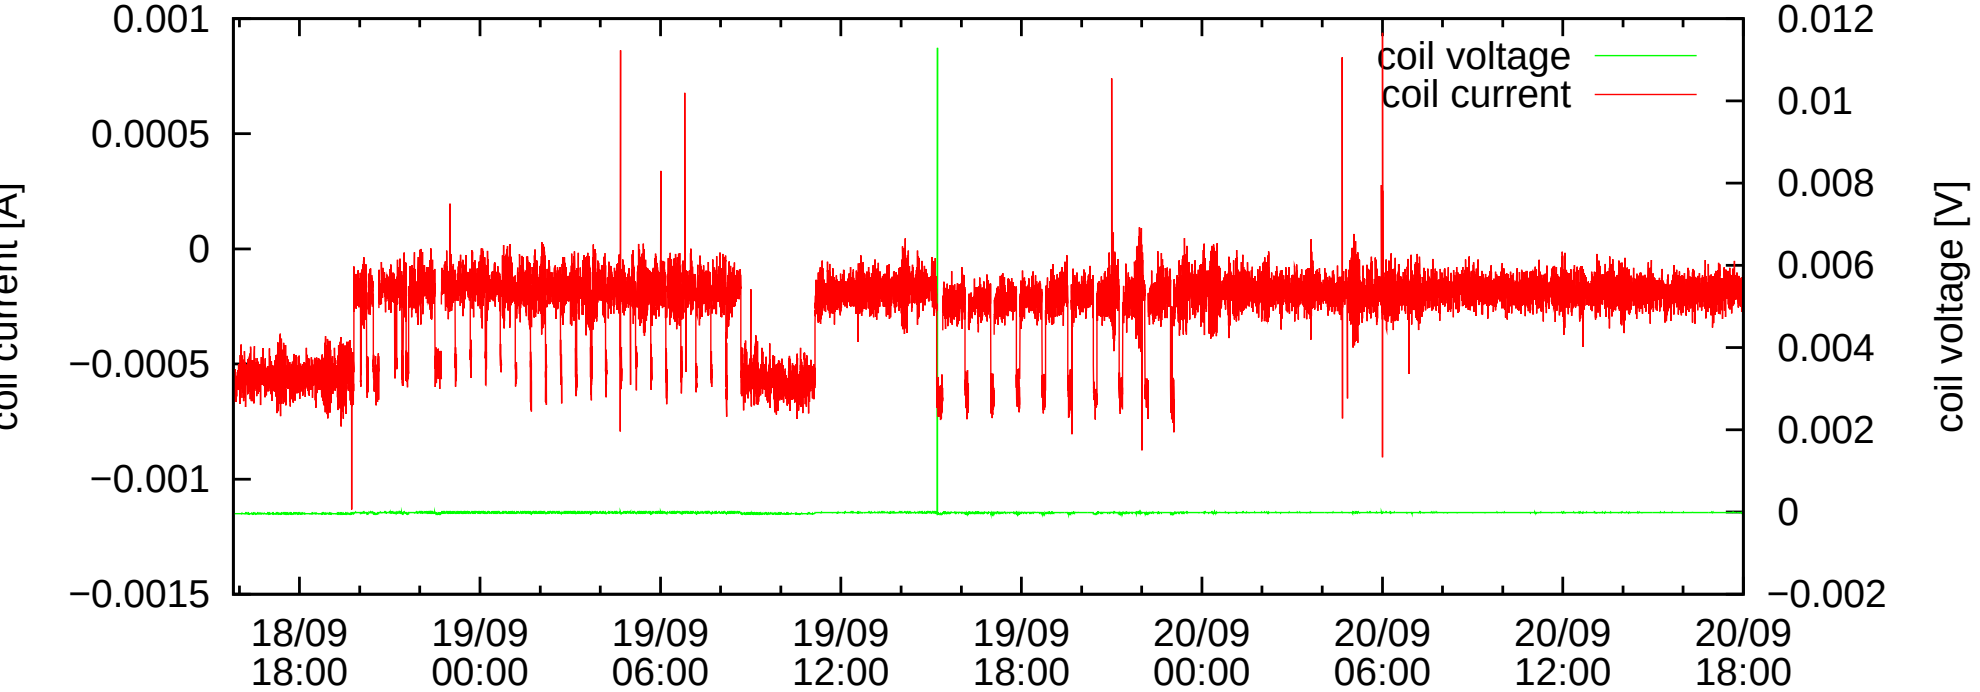
coil voltage
coil current
coil current [A]
coil voltage [V]
0.001
0.0005
0
−0.0005
−0.001
−0.0015
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
−0.002
18/09 18:00
19/09 00:00
19/09 06:00
19/09 12:00
19/09 18:00
20/09 00:00
20/09 06:00
20/09 12:00
20/09 18:00

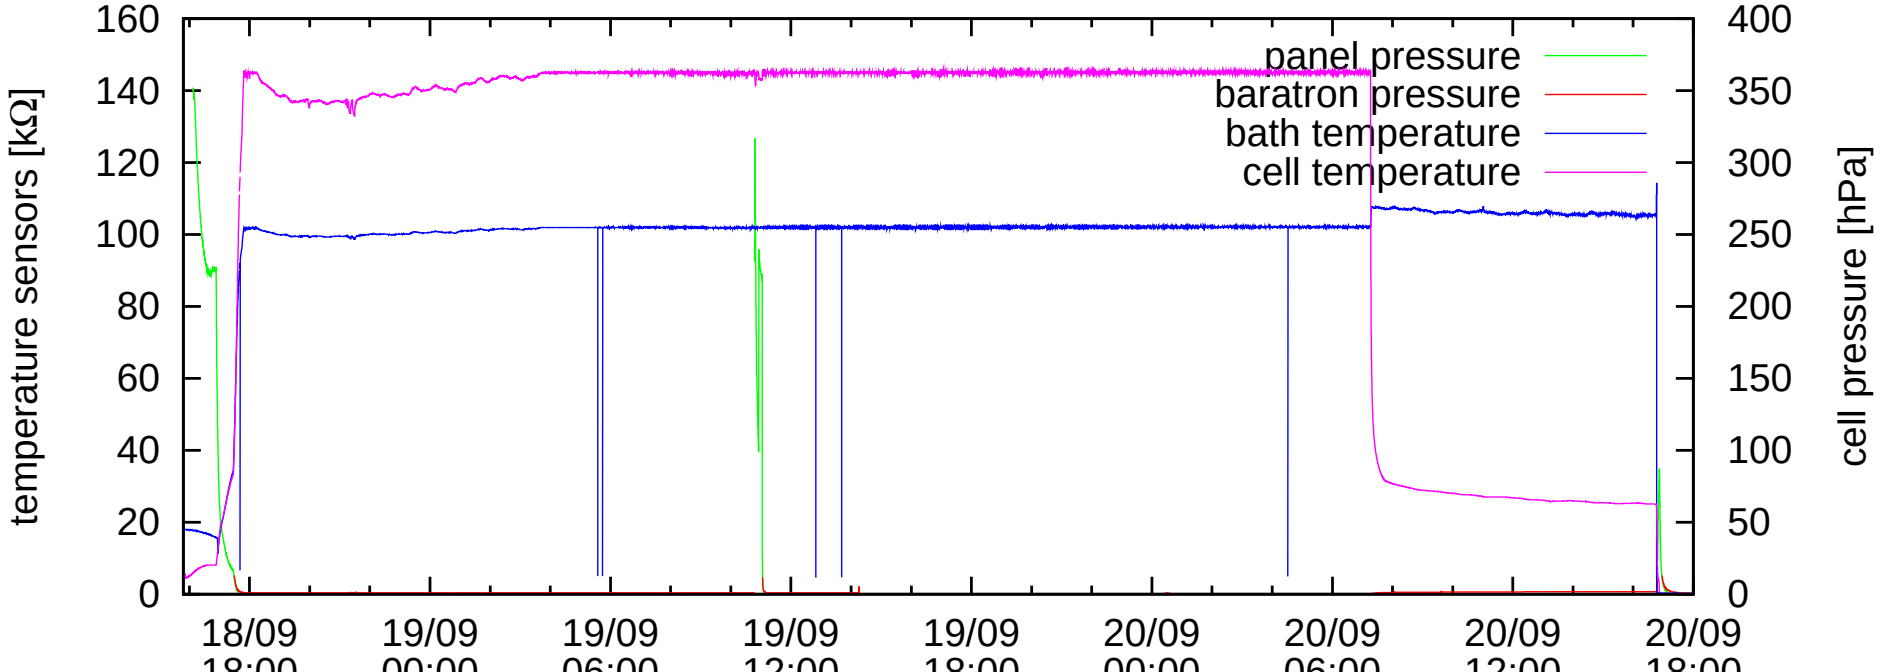
panel pressure
baratron pressure
bath temperature
cell temperature
temperature sensors [kΩ]
cell pressure [hPa]
160
140
120
100
80
60
40
20
0
400
350
300
250
200
150
100
50
0
18/09 18:00
19/09 00:00
19/09 06:00
19/09 12:00
19/09 18:00
20/09 00:00
20/09 06:00
20/09 12:00
20/09 18:00