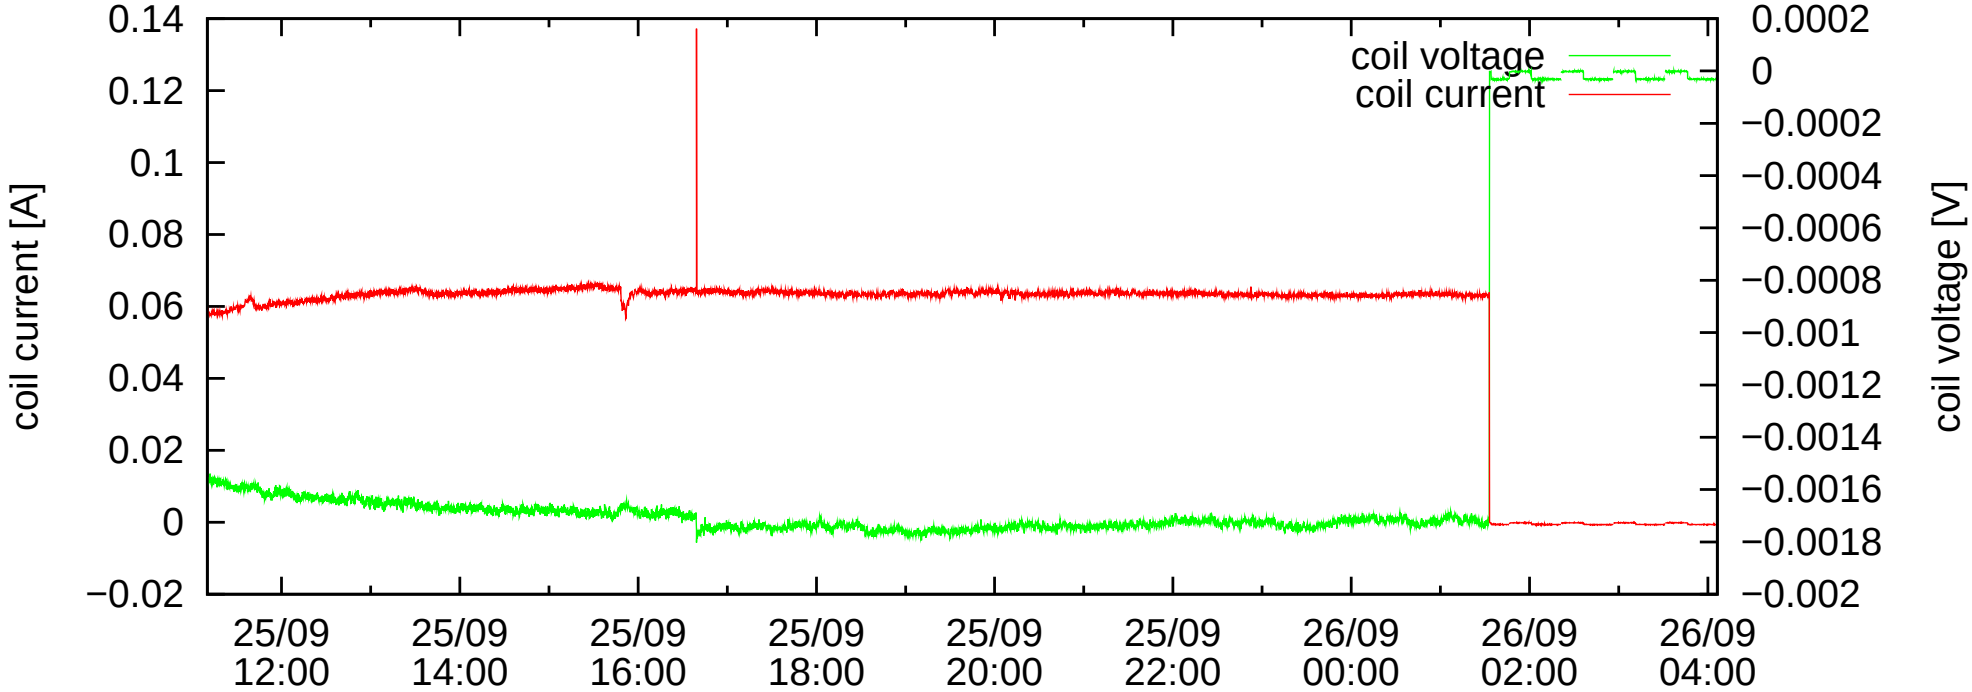
coil voltage
coil current
coil current [A]
coil voltage [V]
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
−0.02
0.0002
0
−0.0002
−0.0004
−0.0006
−0.0008
−0.001
−0.0012
−0.0014
−0.0016
−0.0018
−0.002
25/09 12:00
25/09 14:00
25/09 16:00
25/09 18:00
25/09 20:00
25/09 22:00
26/09 00:00
26/09 02:00
26/09 04:00

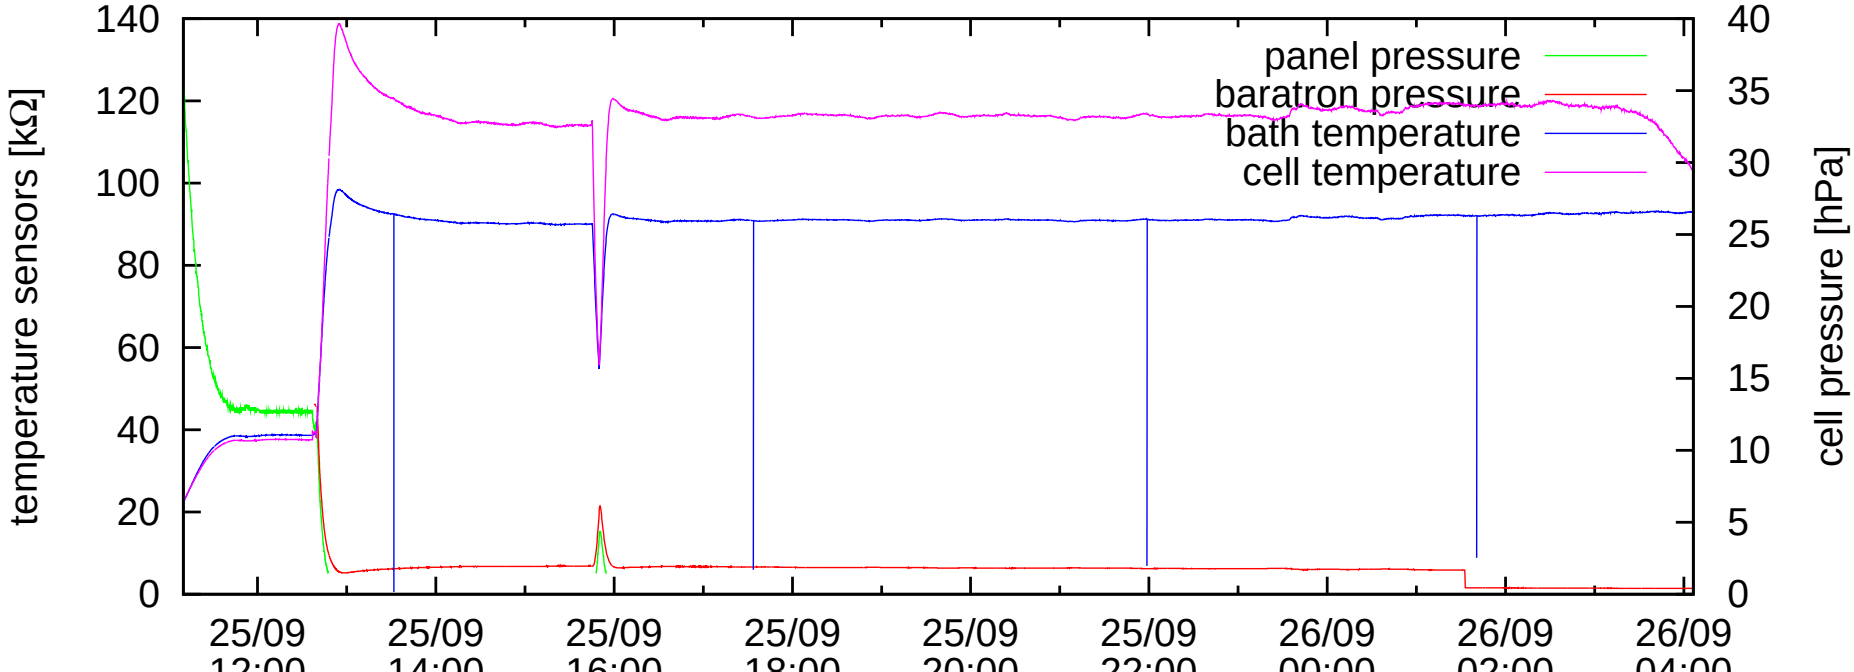
panel pressure
baratron pressure
bath temperature
cell temperature
temperature sensors [kΩ]
cell pressure [hPa]
140
120
100
80
60
40
20
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
25/09 12:00
25/09 14:00
25/09 16:00
25/09 18:00
25/09 20:00
25/09 22:00
26/09 00:00
26/09 02:00
26/09 04:00