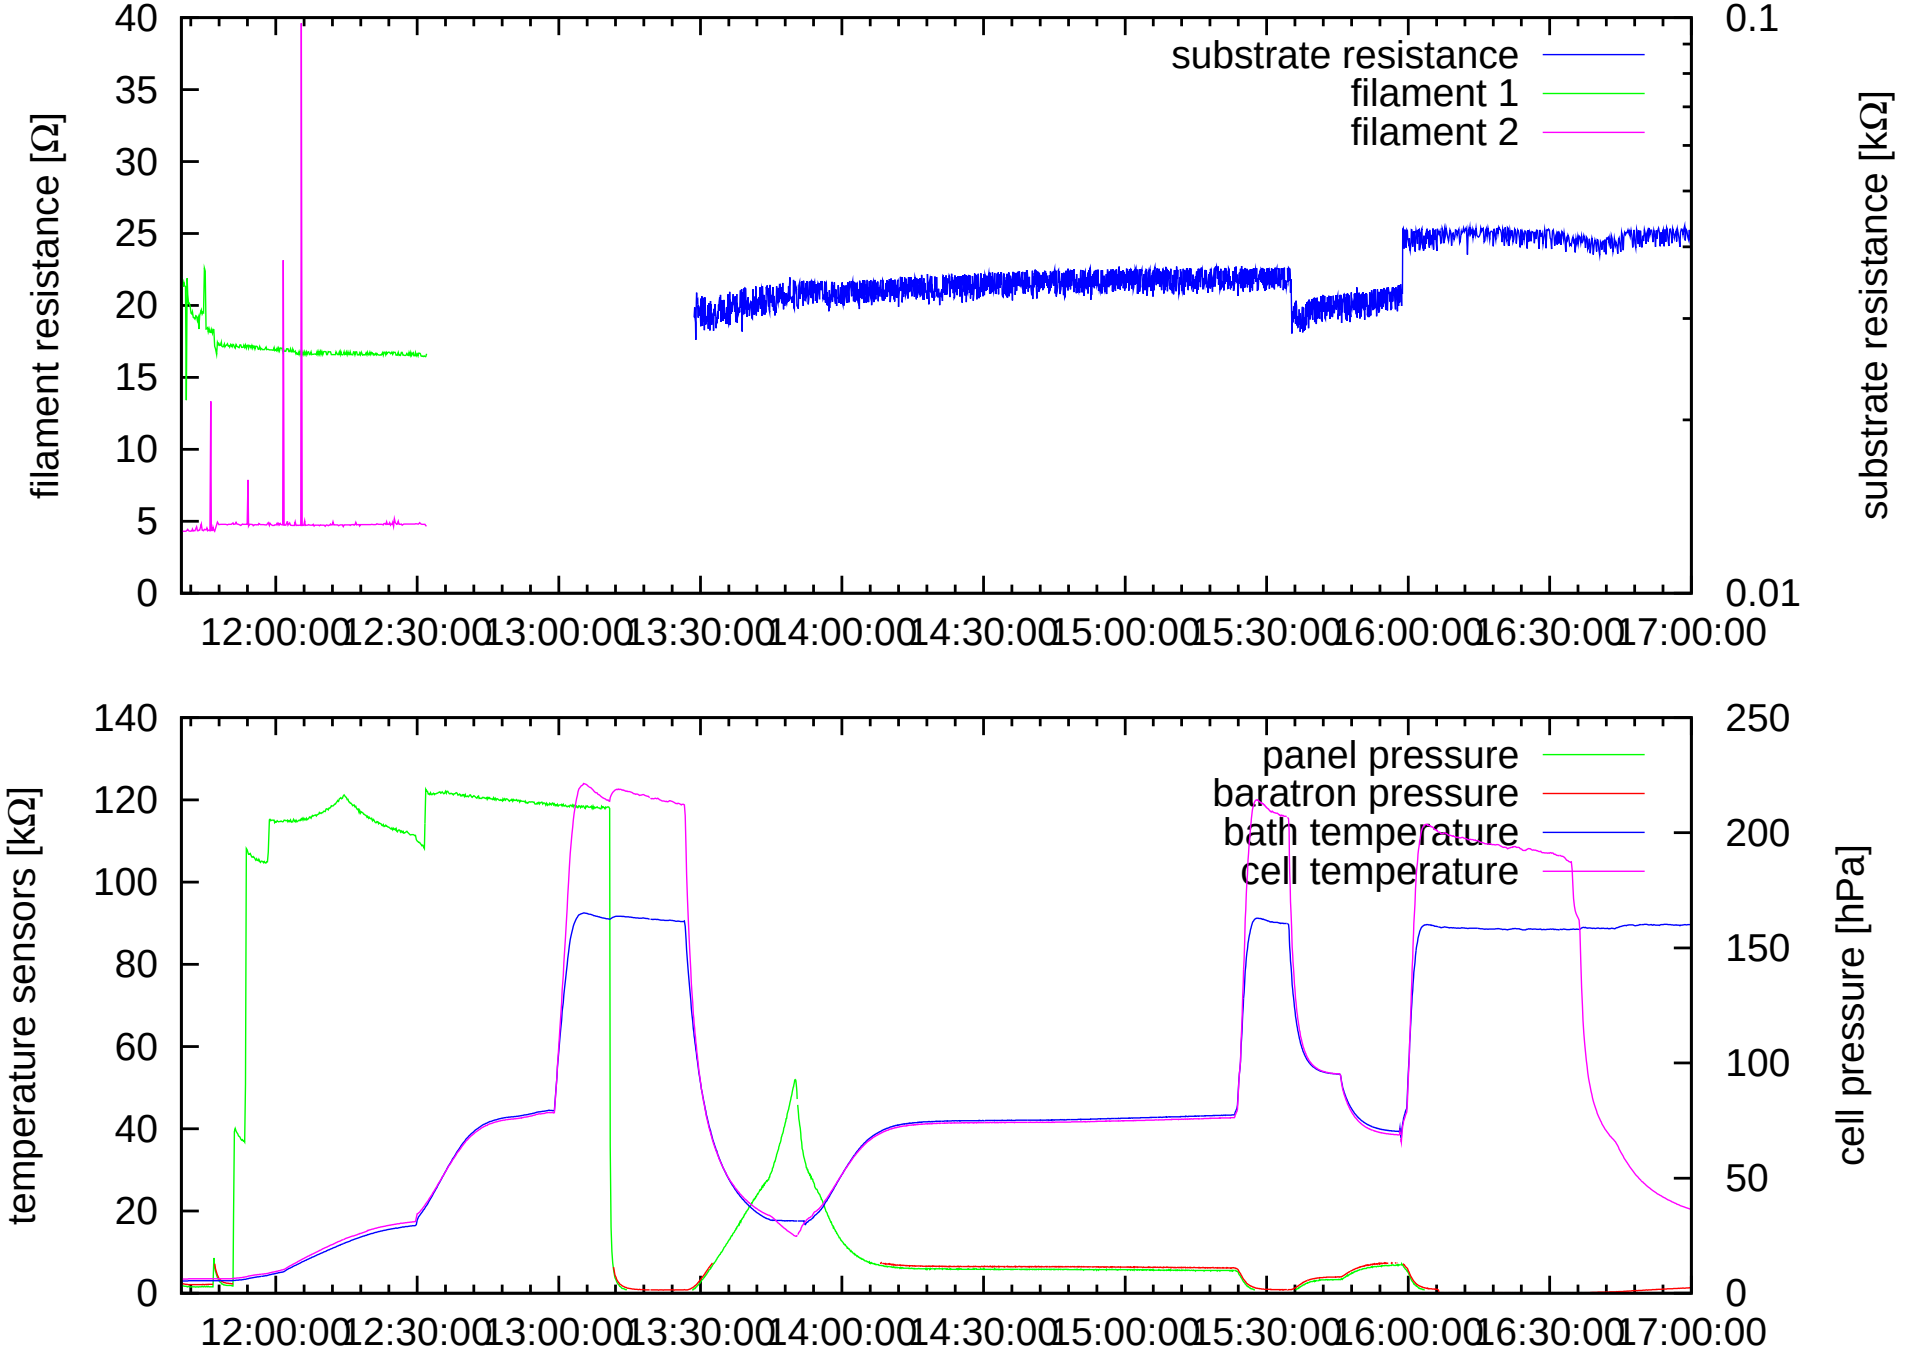
substrate resistance
filament 1
filament 2
filament resistance [Ω]
substrate resistance [kΩ]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0.01
0.1
12:00:00
12:30:00
13:00:00
13:30:00
14:00:00
14:30:00
15:00:00
15:30:00
16:00:00
16:30:00
17:00:00
panel pressure
baratron pressure
bath temperature
cell temperature
temperature sensors [kΩ]
cell pressure [hPa]
0
20
40
60
80
100
120
140
0
50
100
150
200
250